


Wartung von KaVo Instrumenten in der zahnärztlichen Praxis.

Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer
von rotierenden Instrumenten.

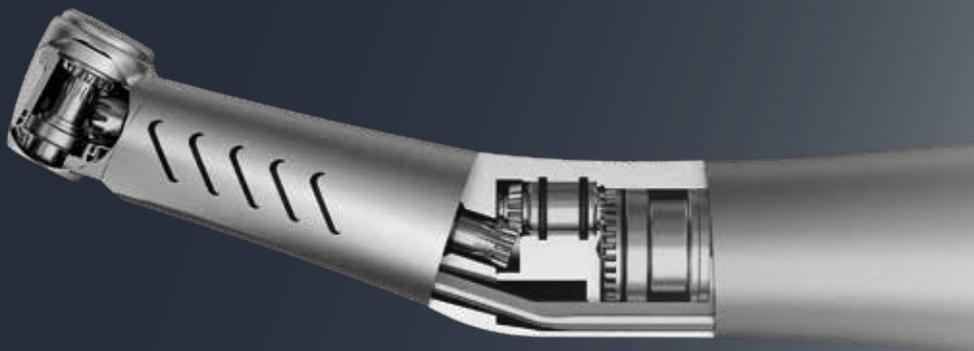

KAVO

| | |
|---|-----------|
| Vorwort..... | 4 |
| 1. Allgemeines | 6 |
| 1.1 KaVo Original Ersatzteile | 7 |
| 2. Werterhaltung Spannsystem | 8 |
| 2.1 Rotierende Instrumente bzw. Bohrer | 8 |
| 2.2 Abmessungen der Fräser und Schleifer..... | 8 |
| 2.3 Entfernen von Kronen und Brücken | 10 |
| 2.4 Entlastung der Spannzange..... | 11 |
| 3. Werterhaltung Kugellager | 13 |
| 4. Werterhaltung Fallschäden/Sturzschäden..... | 14 |
| 4.1 Fallschäden/Sturzschäden vermeiden..... | 14 |
| 5. Häufige Anwendungsfehler | 15 |
| 5.1 Aufbereitung..... | 15 |
| 5.2 Pflege | 16 |
| 5.3 Trocknung und Lagerung..... | 17 |
| 6. Beseitigung von Funktionsstörungen | 18 |
| 6.1 Verstopfungen entfernen..... | 18 |
| 6.2 Austausch Wasserfilter..... | 19 |
| 6.3 Austausch O-Ringe..... | 20 |
| 7. Pflegemittel und Ersatzteile | 21 |
| 8. Anmerkungen..... | 23 |

Wir freuen uns, dass Sie sich für die hochwertigen KaVo Instrumente entschieden haben und möchten Ihnen in dieser Broschüre Tipps geben, wie Sie Ihre KaVo Instrumente möglichst lange nutzen können.

KaVo untersucht Reklamationen sehr gewissenhaft. Viele Defekte können vermieden werden, wenn einige Regeln zur Wiederaufbereitung von Instrumenten beachtet werden.

Mit guter Reinigung und Pflege können Ihre KaVo Instrumente auch noch nach vielen Jahren zuverlässig im Einsatz sein.

Über

50%

der Instrumentenausfälle entstehen durch eine ungenügende Reinigung und Pflege oder Anwendungsfehler.

Falsch gepflegte Instrumente



Richtig gepflegte Instrumente



1. Allgemeines



1.1 KaVo Original Ersatzteile

Nicht originale bzw. gefälschte Ersatzteile können Schäden am Produkt verursachen.

Vorteile von KaVo Original Ersatzteilen:

- Höchste Patienten- und Anwendersicherheit
- Langlebigkeit durch Lebensdauertests und stetige Verbesserungen
- KaVo Reparaturgarantie

Verwendet der Anwender keine KaVo Original Ersatzteile, arbeitet er mit einem von KaVo nicht mehr zugelassenen Medizinprodukt:

- Der Ersatzteilhersteller oder der Zahnarzt wird dann Hersteller des Medizinproduktes
- Der Garantieanspruch bei KaVo erlischt
- Es sind Unfälle durch gefälschte Ersatzteile bei Zahnärzten vorgekommen



KaVo Original Werksreparatur

Im Falle einer Reparatur senden Sie Ihr Produkt bitte an die KaVo Original Werksreparatur über www.kavo.com

KaVo Technischer-Service:

Bei technischen Fragen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an den KaVo Technischen-Service:
+49 (0) 7351 56-1000
service.instrumente@kavokerr.com

2. Werterhaltung Spannsystem

2.1 Rotierende Instrumente bzw. Bohrer

Werden Bohrer verwendet, deren Spezifikation von KaVo nicht freigegeben wurde, kann das Übertragungsinstrument erheblich beschädigt werden. Beschädigungen sind z.B.: Defekte am Spannsystem oder am Bohrerschaft.

Beschädigte Schäfte mit Rillen
(Rillen spürt man beim Abtasten der Schäfte mit dem Fingernagel)



2.2 Abmessungen der Fräser und Schleifer

Herstellerangaben zu Länge, Durchmesser, Schaftform und max. Drehzahl sind in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Übertragungsinstrumente enthalten.

Hinweis zur Schafteinspannlänge:

Der Bohrerschaft muss auf der minimalen Schafteinspannlänge glatt sein.

- Bei KaVo Miniturbinen und Schnellläufer M05 L beträgt die min. Schafteinspannlänge 9 mm
- Bei KaVo Standardturbinen und Schnellläufer beträgt die min. Schafteinspannlänge 11 mm

Folgen bei Missachtung der Herstellervorgaben:

- Die Bohrerhaltekraft kann durch einen abgenutzten Schaft zu gering sein und der Bohrer kann während der Behandlung herausfallen
 - Der Schaft kann in der Spannzange durchdrehen und zerstört die Spannzange. Das Werkzeug kann herausfallen
 - Die Kugellager, die Zahnräder und die Spannzange können z. B. durch zu lange Werkzeuge zu stark belastet werden
 - Ein Schaft mit Einstich/Rille, kann sich im Einspannbereich des Instruments verklemmen
-

Einstiche/Rillen im Einspannbereich können zu beschleunigtem Verschleiß/Verklemmen des Spannsystems führen.



2. Werterhaltung Spannsystem

2.3 Entfernen von Kronen und Brücken

Bohrerhersteller bieten auf unterschiedliche Kronenmaterialien abgestimmte Kronentrenner an. Sie empfehlen zum Beispiel bei Kronen aus Metall oder Weichkeramik einen speziellen Kronentrenner aus Hartmetall zu verwenden. Dagegen muss bei Kronen aus Zirkonoxid ein Diamant-Kronentrenner verwendet werden.

Bitte halten Sie die empfohlenen Drehzahlen der Bohrerhersteller ein. Bei gerad- oder kreuzverzahnten Kronentrennern sind diese häufig niedriger als bei diamantierten Kronentrennern.

Beim Einhaken des Kronentrenners ist das Instrument sofort zu stoppen!

Werden verzahnte Kronentrenner empfohlen, sind kreuzverzahnte Kronentrenner vorzuziehen, weil geradverzahnte Kronentrenner häufiger dazu neigen, im Kronenmaterial einzuhaken. Durch abruptes Einhaken wird das Spannsystem des Winkelstücks bzw. Turbine stark beansprucht und die Spannzange und der Kronentrenner können hierbei einem schnelleren Verschleiß unterliegen.

Ein gerade verzahnter Kronentrenner wird nicht empfohlen



Unabhängig von der Art des verwendeten Kronentrenners führt ein zu hoher Anpressdruck ebenfalls zu einem schnelleren Verschleiß des Spannsystems. KaVo empfiehlt einen Anpressdruck von 2-3 N.

Die Lebensdauer des Hand- und Winkelstücks bzw. Turbine hängt wesentlich von der Schmierung des Spannsystems, der Kugellager und des Getriebes ab. KaVo empfiehlt daher bei einer Betriebszeit von mehr als 20 Minuten innerhalb einer Behandlung auf ein frisch gepflegtes Instrument zu wechseln.

2.4 Entlastung der Spannzange

Instrument ohne Bohrer



Instrument mit eingesetztem Bohrer



Die Spannzange soll während der Lagerung entlastet sein, um die Lebensdauer zu erhöhen. Bei Lagerung der Instrumente mit Bohrer besteht u.a. Verletzungs- bzw. Infektionsgefahr.

Spannring des Handstückes schliessen

Das gerade Handstück niemals mit offener Spannzange in Betrieb nehmen, da die Spannzange des Handstücks blockiert

Druckknopf nie während des Betriebs betätigen

Den Druckknopf an der Turbine bzw. am Winkelstück niemals bei rotierendem Instrument betätigen. Darauf achten, dass genügend Abstand zwischen Druckknopf und Wange/Weichgewebe während der Präparation vorhanden ist.

2. Werterhaltung Spannsystem

Druckknopf wird im Betrieb betätigt



Folgen einer Betätigung im Betrieb sind:

- Funktionsstörungen am Druckknopf
- Die Spannzange löst nicht bzw. nur schwer aus
- Metallische Abriebe des Deckels können in die Kugellager geraten
- Der Druckknopf kann stark erhitzen
- Starker Verschleiß an Trieb/Läufer

Die Wange des Patienten niemals mit dem Druckknopf abhalten.

Durch die Reibung zwischen dem Druckknopf und dem Spannsystem entsteht Hitze, die zur Verbrennung der Mundschleimhaut führen kann.

Druckknopf bei korrekter Anwendung



Druckknopf wurde durch nicht korrekte Anwendung verschlissen



3. Werterhaltung Kugellager

Kugellager z.B mit KaVo Spray oder mit QUATTROcare pflegen:

Durch eine unzureichende Pflege der Kugellager verschleßen diese stark und können beschädigt werden. Um Folgeschäden zu vermeiden, defekte Kugellager frühzeitig austauschen lassen.

Anzeichen für defekte Kugellager sind:

- Laute Laufgeräusche
- Unrunder Lauf
- Komplette Blockade des Instruments
- Starke Temperaturerhöhung

Richtig gepflegtes Kugellager



Falsch bzw. nicht gepflegtes Kugellager



Bereits das einmalige Auslassen der Pflege, insbesondere nach einer Innenreinigung, kann zu Vorschädigungen am Kugellager führen.

4. Werterhaltung Fallschäden/Sturzschäden

4.1 Fallschäden/Sturzschäden vermeiden

Das Instrument visuell auf Veränderungen prüfen, um das Instrument und den Patienten zu schützen.

Instrumente mit Fallschäden/Sturzschäden.



Folgeschäden, wie das Verklemmen von Kugellagern, können thermische Schädigungen der Kugellager und somit einen schnellen Ausfall verursachen.

Vorgehensweise zum Erkennen von Fallschäden/Sturzschäden:

- Sichtprüfung auf äußere Schäden zeigt Verformung
- Funktionsprüfung zeigt ein zu lautes Laufgeräusch bzw. eine übermäßige Erwärmung

Bei Unsicherheiten zu Fallschäden/Sturzschäden Ihren KaVo-Service kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.

5. Häufige Anwendungsfehler

5.1 Aufbereitung



Das Instrument darf niemals in ein Desinfektions-/Ultraschallbad getaucht werden, da:

- Die Kugellager zerstört werden können
- Weitere technische Defekte am Instrument auftreten können

Freigegebene Medien / Desinfektionsmittel:

Niemals chloridhaltige Desinfektionsmittel benutzen. Ungeeignete Desinfektionsmittel können zu einer Korrosion führen. Ausschließlich vom Hersteller freigegebene Mittel verwenden; siehe Gebrauchsanweisung.



Empfohlene Wischdesinfektion



Wird zu viel oder ein nicht zugelassenes Desinfektionsmittel auf das Instrument oder die Motor-/Turbinenkupplung gesprüht, können Funktionsstörungen auftreten.



Wenn das Desinfektionsmittel in das Instrument oder in die Motor-/Turbinenkupplung läuft, können Defekte an der Kupplung und am Motor auftreten.

Weitere Hinweise zur Aufbereitung von dentalen Instrumenten entnehmen Sie bitte dem KaVo-Aufbereitungsposter sowie der jeweiligen Gebrauchsanweisung der KaVo Instrumente.

5. Häufige Anwendungsfehler

5.2 Pflege

Die Lebensdauer der Hand- und Winkelstücke bzw. Turbinen hängt wesentlich von der Pflege des Spannsystems, der Kugellager und des Getriebes ab.

Generell ist eine maschinelle Pflege mit dem QUATTROcare PLUS einer manuellen Pflege vorzuziehen. KaVo übernimmt nur Garantie für eine einwandfreie Funktion der KaVo Produkte bei Verwendung der von KaVo freigegebenen Pflegemittel.

Die Instrumente nach jeder Reinigung und Desinfektion pflegen. Sofern möglich, die Instrumente und Köpfe getrennt pflegen.

Die Spannzange mindestens einmal pro Woche pflegen, bei intensivem Einsatz (z. B. Kronen trennen) auch häufiger.

Folgende Möglichkeiten gibt es hierzu:

1. Bei QUATTROcare PLUS mit der „Spannzangenpflege“ (0.411.7603)
2. Mit dem Nippel am „Sprühkopf INTRA“ (0.411.9911) des „KaVo Sprays 2112A“ (0.411.9640).
3. Mit dem Spannzangen-Pflegeset (1.003.1253) für das QUATTROcare Plus Spray

Spannzangenpflege



Durch das QUATTROcare PLUS werden Pflegefehler und Folgekosten durch Reparaturen minimiert. KaVo empfiehlt bei einer Betriebszeit von mehr als 20 Minuten innerhalb einer Behandlung auf ein frisch gepflegtes Instrument zu wechseln.

Alle O-Ringe der Pflegekupplungen am QUATTROcare PLUS müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Das Instrument wird sonst nicht richtig gepflegt. KaVo Elektro-Motore dürfen nicht mit Öl gepflegt werden, da diese eine Dauerschmierung besitzen. Luftbetriebene Motore entsprechend der Gebrauchsanweisung pflegen.

5.3. Trocknung und Lagerung

Um Beschädigungen des Medizinprodukts durch Flüssigkeitsrückstände zu verhindern, das Medizinprodukt innen und außen trocknen. Die Flüssigkeitsreste mit Druckluft innen und außen entfernen, ansonsten kann Korrosion entstehen.



- Zur Aufbewahrung stets einen Instrumentenständer benutzen (3.005.5204)
- Überschüssiges Öl läuft aus
- Ansonsten kann das Instrument im erneuten Betrieb zu heiß werden und zu Schäden an den Kugellagern führen

Das gepflegte Instrument niemals auf die Motor-/Turbinenkupplung stecken und im Köcher lagern. Das Öl läuft in den Schlauch und es kann zu einem Defekt an der Kupplung kommen.

6. Beseitigung von Funktionsstörungen

6.1 Verstopfungen entfernen

6.1.1 Instrumente

Verstopfungen der Spraykanäle können durch kalkhaltiges Wasser entstehen. Bei zu geringem Spraywasseraustritt an den Sprayöffnungen bitte prüfen, ob die Spraykanäle verschmutzt sind und ggf. reinigen.

Folge einer zu geringen Wassermenge ist die Schädigung des Zahnes und der Pulpa durch Überhitzung.

Kurzfristige Beseitigung:

Nur mit den vom Hersteller beigelegten, dafür vorgesehenen Düsenadeln die Spraydüsen reinigen und niemals mit einer Wurzelkanalnadel die Spraydüsen aufstechen. Ansonsten können die Spraykanäle beschädigt werden.

Vorsicht: Das Instrument niemals in einen Kalklöser legen oder damit einsprühen, da Korrosion entstehen kann.

Düsenadel von KaVo



Verwendung der Wurzelkanalnadel



Die Reinigung der Spraydüsen durch eine von KaVo zertifizierte Reparaturwerkstatt.

6.2 Austausch Wasserfilter

Folgen eines verschmutzten Wasserfilters sind eine schlechte Sprayqualität und eine zu geringe Wassermenge. Der Austausch des Wasserfilters ist in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben.

Wechsel eines Wasserfilters



Neuer Wasserfilter
(Materialnummer siehe Kapitel 8)




6.3 Austausch O-Ringe

Ablauf zum Austausch der O-Ringe:


Beim Austausch der O-Ringe immer alle O-Ringe austauschen. Keine scharfen/harten Werkzeuge verwenden.

- O-Ringe zwischen den Fingern zusammendrücken, sodass der O-Ring sich leicht abhebt
- O-Ringe nach vorne abziehen

O-Ring-Wechsel an einer
INTRAmatic Kupplung

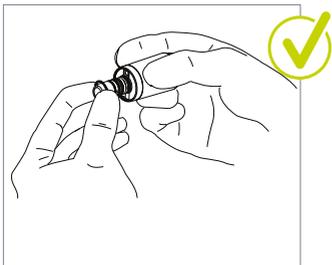

O-Ring-Wechsel an einer
MULTIflex Kupplung

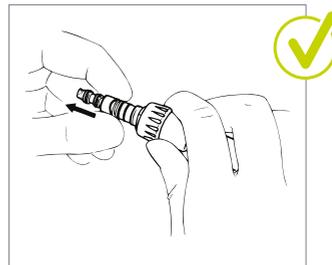

Pflege der O-Ringe:

- Ausschließlich empfohlene Fette und Öle (KaVo-Spray) verwenden, da sich die O-Ringe zersetzen oder durch andere Chemikalien aufquellen können
- Keine Vaseline benutzen

Tipps, um die Haltbarkeit von O-Ringen zu verlängern:

- Das Instrument gerade und mit leichter Drehbewegung auf die Motor-/Turbinenkupplung aufsetzen und abnehmen
- Die O-Ringe nur mit einem Wattebausch ölen, welcher mit KaVo Öl benetzt ist

Produktname

Materialnummer

| | |
|---|------------|
| Wasserfilter (GENTLEforce, GENTLEsince, GENTLEmini) | 1.000.4823 |
| Wasserfilter (COMFORTdrive, MASTERmatic, GENTLEpower, MASTERtorque, EXPERTtorque, EXPERTmatic) | 1.002.0271 |
| Schlüssel für Wasserfilter | 1.002.0321 |
| O-Ring (MULTIflex Kupplung schwarz), 10 St. | 1.004.2776 |
| O-Ring (MULTIflex Kupplung weiß), 10 St. | 1.004.2775 |
| O-Ring (INTRAmatic Motor), 10 St. | 0.200.6120 |
| Multi LED (Instrumente) | 1.007.5372 |
| Hochdrucklampe (MULTIflex LUX-Kupplungen, Luft- und Elektromotoren) | 1.002.2928 |
| Düsenadel (Sprayröhrchen INTRA, INTRAmatic) | 0.410.0931 |
| Düsenadel (Instrumente) | 0.410.0921 |
| Spray-Reparatursatz (INTRA, INTRA LUX) | 0.410.0610 |
| Instrumentenständer | 3.005.5204 |
| Einsatz für Instrumentenständer (MULTIflex) | 0.411.9902 |
| Einsatz für Instrumentenständer (COMFORTdrive) | 1.006.0525 |
| Zellstoffauflage (für Instrumentenständer) | 0.411.9862 |

7. Pflegemittel und Ersatzteile

8. Anmerkungen

| Produktname | Materialnummer |
|---|-----------------------|
| KaVo Spray 2112A (Karton mit 6 Dosen) für manuelle Öl-Pflege | 0.411.9640 |
| Sprühkopf (INTRA) für Hand- Winkelstücke, Köpfe, Spannzangen | 0.411.9911 |
| Sprühkopf (COMFORTdrive) | 1.005.3154 |
| Sprühkopf (MULTIflex) für Turbinen, SONICflex, INTRAflex | 0.411.9921 |
| Packung Cleanpac, 10 St. | 0.411.9691 |
| QUATTROcare PLUS 2124A Pflegegerät | 1.008.3805 |
| QUATTROcare PLUS Spray 2140P (Karton mit 6 Dosen) | 1.005.4525 |
| INTRAmatic kurz | 1.011.7380 |
| Pflegekupplung für KaVo Instrumenten-Köpfe | 0.411.7941 |
| Pflegekupplung MULTIflex | 1.009.6142 |
| Pflegekupplung COMFORTdrive | 1.005.1707 |
| Pflegekupplung Spannzange (zur maschinellen Pflege der Spannzangen) | 0.411.7603 |
| Spannzangen-Pflegeset (für die manuelle Pflege mit QUATTROcare Plus Spray) | 1.003.1253 |

Wir arbeiten ständig daran, die Zufriedenheit unserer Kunden zu steigern und haben in dieser Broschüre Informationen zusammengestellt, um die Lebensdauer Ihrer rotierenden Instrumente zu verlängern.

Wenn Ihnen aus Ihrem Alltag weitere typische Pflegefehler bekannt sind, oder Sie zu einem Thema einen detaillierteren Erklärungsbedarf sehen, würden wir uns über eine Rückmeldung an service.instrumente@kavokerr.com freuen.

Vielen Dank!

Dental Excellence in jedem Bereich.



Praxisausstattung

KaVo Behandlungseinheiten, Behandlungsleuchten, Behandlerstühle, Patientenkommunikationssystem, Dentalmikroskope und weiteres Zubehör für die zahnärztliche Praxis.



Instrumente

Dentale Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Pulverstrahlhandstücke und Kleingeräte für alle Anwendungsgebiete von Diagnostik über Prophylaxe bis hin zu Restauration, Chirurgie, Endodontie und Instrumentenpflege.



Imaging

Intraorale Strahler, Sensoren und Speicherfolien, Panorama- und Fernröntgen, auch mit DVT Kombination, sowie dedizierte DVT Geräte für jede Indikation in der Zahnmedizin.



CAD/CAM

Dentale CAD/CAM Lösungen für hochästhetische, naturidentische und langlebige Restaurationen, passend für Zahnärzte und Zahntechniker.